



Zielona Góra 03.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zg. z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy wyrobów jednorazowego i wielorazowego użytku** - nr sprawy: **ZP.382.2.2024**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIĘĆ TREŚCI II

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 23 poz. 1 postępowania kompatybilny z wstrzykiwaczem Ulrich CT Motion zestaw zapewniający pracę przez 24 godziny, składający się z 2 wężyków pompy o czasie pracy do 12 godzin oraz wytrzymałości ciśnieniowej 24 bar, spełniający wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 23 poz. 2 postępowania kompatybilny z wstrzykiwaczem Ulrich CT Motion wężyków pacjenta o wytrzymałości ciśnieniowej 24bar, spełniający wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

WZÓR UMOWY dla zadań nr 1 -3, 5 – 10, 12 -13, 16 – 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 6 ust. 1 pkt. 2 do 1% ?
Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy. 2.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

WZÓR UMOWY dla zadań nr 1 -3, 5 – 10, 12 -13, 16 – 25:

Wniosek o dopisanie: Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Zadanie 1, poz. 9-12,

Czy zamawiający wydzieli poz.9-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na



dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Zadanie 3, poz. 19,21,31-32,

Czy zamawiający wydzieli poz. 19,21,31-32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Zadanie 3, poz. 19

Czy zamawiający dopuści dren o długości 90, bez możliwości wyboru innej długości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 9

Zadanie 13, poz. 2

Czy zamawiający wymaga szczoteczki typu prostego – cytobraszka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szczoteczkę cytologiczną końcówka typu prostego („kształt szczoteczki do rzęs”).

Pytanie nr 10

Zadanie 13, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 11

Zadanie 20, poz. 2

Czy zamawiający dopuści standardowy czepek typu furażerka , o gramaturze ok. 25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12

Zadanie 20, poz. 5

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMS, wymagana gramatura włókniny min. 35 gr/m2.



Pytanie nr 13

Zadanie 20, poz. 8

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS?

Czy zamawiający dopuści gramaturę fartucha min. 35 g/m² i gramaturę wzmocnienia 38 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMS, dopuszcza gramaturę fartucha min. 35 g/m² i gramaturę wzmocnienia 38 g/m².

Pytanie nr 14

Zadanie 20, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 15

Zadanie 24, poz. 1

Czy zamawiający dopuści worki w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Zadanie 24, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 17

Zadanie 24, poz. 7

Czy zamawiający dopuści stazę która można dezynfekować wacikiem/gazą nasączoną środkiem dezynfekującym - alkoholem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Zadanie 24, poz. 1-11,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 15-30ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys Ø37-Ø31 x 44 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 15-30ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys $\varnothing 37\text{-}\varnothing 31 \times 44$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 21

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 50-80 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys $\varnothing 60\text{-}\varnothing 48 \times 64$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 22

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji 4 wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 100-150ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys $\varnothing 58\text{-}\varnothing 52 \times 80$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 23

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji 5 wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 200-250ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) $\varnothing 65 - \varnothing 59 \times 100$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Pozycja 6: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 500 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) $\varnothing 117,5\text{-} \varnothing 100,5 \times 80,6$ mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.



Pytanie nr 25

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji 7 wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 1000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø132,5 - Ø105,2 x 131,2 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 26

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji 8 wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 3 000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø200,0 - Ø168,0 x 154,8 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 27

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Pozycja 9: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 5000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 28

Dotyczy: Zadanie 11 - sukcesywne dostawy pojemników do badań histopatologicznych

Czy Zamawiający w pozycji 10 wymaga: Pojemniki chirurgiczne do przechowywania i transportu materiałów tkankowych. Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Pojemniki wykonane z polipropylenu (PP). Zamknięcie dociskowe, jednorazowe, szczelne, odporne na uszkodzenia. Pojemniki bez formaliny o pojemności 10000 ml i wymiarach (średnica górna – średnica dolna x wysokość): Ø293,0 – Ø255,5 x 221,5 mm oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania).?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników opisanych w formularzu cenowo-technicznym zad. 11 z uwzględnieniem wyjaśnień do treści SWZ z 28.03.2024 r.

Pytanie nr 29

Zadanie 1, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a`50 z odpowiednim przeliczaniem ilości?



Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 30

Zadanie 2 , poz. 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki Yankauer z jednym otworem końcowym oraz 4 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31

Zadanie 2 , poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kontrolą siły ssania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32

Zadanie 2 , poz. 8-10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki Yankauer z jednym otworem końcowym oraz 4 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33

Zadanie 3 , poz. 3-4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z plastikową zastawką bez zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pozycji 3 zadania 3. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w zakresie poz. 4 zadania 3.

Pytanie nr 34

Zadanie 3 , poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zatyczki pakowanej osobno?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35

Zadanie 3 , poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Tieman o powierzchni niezmrózonej?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36

Zadanie 3 , poz. 7-13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o powierzchni niezmrózonej?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37

Zadanie 3 , poz. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego z kolorystycznym oznaczeniem na końcu dystalnym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38

Zadanie 3 , poz. 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.



Pytanie nr 39

Zadanie 3 , poz. 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a`10 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „*Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”.

Pytanie nr 40

Zadanie 3 , poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Zadanie 13 , poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do cytologii o pojemności 150ml z przeliczeniem ilości do 4 opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „*Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”.

Pytanie nr 42

Zadanie 20, poz. 1, 2, 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a`100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „*Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”.

Pytanie nr 43

Zadanie 20, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o gramaturze włókniny 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 44

Zadanie 20, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o gramaturze włókniny 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

Zadanie 20, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o gramaturze włókniny w części bocznej 45g/m², a w części górnej 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

Zadanie 20, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a`50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?



Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „*Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”.

Pytanie nr 47

Zadanie 20, poz. 5, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMS , wymagana gramatura włókniny min. 35 gr/m2.

Pytanie nr 48

Zadanie 20, poz. 5, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMS, w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49

Zadanie 20, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50

Zadanie 24, poz. 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „*Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”.

Pytanie nr 51

Zadanie 24, poz. 3– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’90 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „*Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”.

Pytanie nr 52

Zadanie 24, poz. 15– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy automatycznych w rozmiarach 23G-1,8mm oraz 21G – 2,4mm w opakowaniach po 100szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53

Zadanie 24, poz. 16, 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okładów pakowanych a’1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „*Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę*”.

Pytanie nr 54

Zadanie 24, poz. 20– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularków ochronnych do fototerapii noworodka w rozmiarze 300-400mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 55

Zadanie 24, poz. 21– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularków ochronnych do fototerapii noworodka w rozmiarze 240-340mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 56

Zadanie 24, poz. 26 – Co Zamawiający rozumnie poprzez ostrza chirurgiczne dwustronne?

Odpowiedź: Krawędź tnąca ścięta dwustronnie.

Pytanie nr 57


Zadanie 24, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści ostrza o kształcie zgodnym z oferowanym rozmiarem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Zadanie 24, poz. 31, 34 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na uchwyt lamp operacyjnych chirurgicznych z kołnierzem ochronnym zapobiegającym przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

Średnica kołnierza 12,7 cm, uchwyt 3,1 cm, wysokość produktu 10,2 cm?

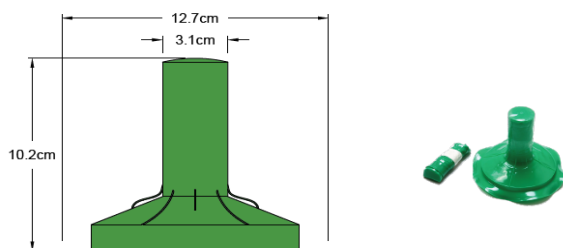

Opakowanie folia papier o wymiarach 20,5 cm x 20,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59

Zadanie 24, poz. 35 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 60

Zadanie 24, poz. 36 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61

Zadanie 25, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezłateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: $0,20 \pm 0,02$, dłoni $0,18 \pm 0,02$ mm, mankiecie $0,16 \pm 0,02$ mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym



o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Zadanie 25, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu $0,17\pm 0,01$, na dłoni $0,14\pm 0,01$, mankiecie $0,11\pm 0,01$; długość min 280 mm. Poziom protein ≤ 30 $\mu\text{g/g}$ i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki niezależnej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Zadanie 25, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu $0,17\pm 0,01$, na dłoni $0,14\pm 0,01$, mankiecie $0,11\pm 0,01$, długość min 280 mm. Poziom protein ≤ 30 $\mu\text{g/g}$. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Zadanie 25, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,08\text{mm} \pm 0,01\text{mm}$, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,06 \pm 0,01\text{mm}$, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37 cytostatyków wg ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt. (pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65



Zadanie 25, poz. 4 – Prosimy Zamawiającego o określenie oczekiwanej wielkości opakowania.

Odpowiedź: Opakowanie po 200 sztuk.

Pytanie nr 66

Zadanie 25, poz. 4 – W przypadku gdy Zamawiający ma na myśli opakowanie a'200 szt. – czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'250 szt. Dla rozm. XS-L oraz a'240 szt. dla rozm. XL z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 288 op.?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 67

Zadanie 25, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm. Siła zrywu nim 12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN ISO 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier. Rozmiary S(6.5), M(7.5), L(8.5)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Zadanie 25, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

Zadanie 25, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisów SWZ – załącznik nr 2 – 26 „Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę”.

Pytanie nr 70

Zadanie 25, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, kolor zielony, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, kształt anatomiczny. Wewnętrzna warstwa pielęgnująca na bazie żelu aloesowego. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji



chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mm, mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie.

Rozmiar 6.0-8.5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71

Zadanie 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH22 lub CH28?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 72

Zadanie 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH15-16?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 73

Zadanie 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem bez łącznika T oraz ustnika?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 74

Zadanie 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem oraz osobno nebulizator z łącznikiem T oraz ustnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 75

Dotyczy: Załącznik nr 2-26 do SWZ – Formularze asortymentowo - techniczne, zadanie 23 poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby informacja, że wężyk pacjenta posiada dwa zawory zwrotne było potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 76

Dotyczy: Załącznik nr 2-26 do SWZ – Formularze asortymentowo - techniczne, zadanie 23, poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnej wężyki pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia

w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanego objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 77

Dotyczy: Załącznik nr 29 do SWZ – Wzór umowy, § 3

Prosimy zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i na etapie zawierania umów z Wykonawcami uwzględni powyższy zapis zarówno w załączniku 29 jak i 30 do SWZ.

Pytanie nr 78

Dotyczy: Załącznik nr 29 do SWZ – Wzór umowy, § 3 ust.2

Prosimy Zamawiającego, aby czas na realizację zamówienia był liczony w dniach roboczych. Prosimy o modyfikację umowy na: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw częściowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w terminie do 3 dni **roboczych** od chwili złożenia zamówienia (...)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i na etapie zawierania umów z Wykonawcami uwzględni powyższy zapis zarówno w załączniku 29 jak i 30 do SWZ.

Pytanie nr 79

Dotyczy: Załącznik nr 29 – Wzór umowy, § 3, ust. 2 (w tym zamówienia CITO)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie (również zamówienia CITO). W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 80

Dotyczy: Załącznik nr 29 – Wzór umowy, § 3, ust.2 (zamówienia CITO)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby czas na realizację zamówienia był liczony w dniach roboczych, a tym samym zmianę zapisu we wzorze umowy z:

„W przypadku zamówień na Cito termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć **24 godzin** od momentu złożenia zamówienia(...)”

na „W przypadku zamówień na Cito termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć **1 dnia roboczego** od momentu złożenia zamówienia (...)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i na etapie zawierania umów z Wykonawcami uwzględni powyższy zapis zarówno w załączniku 29 jak i 30 do SWZ.

Pytanie nr 81

Dotyczy: Załącznik nr 29 – Wzór umowy, § 4 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury w wersji papierowej wraz z wystanym towarem/zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 82

Dotyczy: Załącznik nr 29 – Wzór umowy, § 5, ust.2 pkt. a, b

Prosimy Zamawiającego, aby czas na uzupełnienie braków ilościowych oraz niezrealizowanych pozycji był liczony w dniach roboczych. Prosimy o modyfikację umowy na: „Braki ilościowe oraz niezrealizowane pozycje zlecenia uzupełniane będą przez Wykonawcę w terminie do 2 dni **roboczych** od momentu otrzymania zgłoszenia o takich brakach (...)” ; „Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni **roboczych**



od momentu otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowej realizacji zamówienia w formie e-mail na adres:, dostarczyć towar zgodny z ofertą przetargową.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i na etapie zawierania umów z Wykonawcami uwzględni powyższy zapis zarówno w załączniku 29 jak i 30 do SWZ.

Pytanie nr 83

Dotyczy: Załącznik nr 29 – Wzór umowy, § 5, ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby czas na realizację zamówienia był liczony w dniach roboczych, a tym samym zmianę zapisu we wzorze umowy: z „*Wyroby o niepełnej jakości będą wymieniane przez Wykonawcę w terminie do 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie e-mail na adres:*”

na „*Wyroby o niepełnej jakości będą wymieniane przez Wykonawcę w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie e-mail na adres:*”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i na etapie zawierania umów z Wykonawcami uwzględni powyższy zapis zarówno w załączniku 29 jak i 30 do SWZ.

Pytanie nr 84

Dotyczy: Załącznik nr 29 – Wzór umowy, § 5, ust. 6 pkt. b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z up. Specjalista ds. zamówień publicznych
Joanna Piotrowska
Podpis na oryginale

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.